Bandelette de contrôle automatique

Guide de Référence Rapide

Remarque : Pour commander des bandelettes de contrôle automatique RASC[MD] Pronto[MD], veuillez communiquer avec le bureau de commande du RASC[MD] au 1 866 669-2313.

1 UTILISATION PRÉVUE

La **bandelette de contrôle automatique RASC[MD] Pronto[MD]** est une bandelette réutilisable qui comprend des représentations graphiques de globules blancs (GB) et de neutrophiles dans le format et la taille appropriés. Elle comprend trois niveaux de GB et de pourcentages de neutrophiles (Neut %) pour différentes concentrations. La bandelette de contrôle automatique RASC[MD] Pronto[MD] est destinée à vérifier la fiabilité du RASC[MD] Pronto[MD] et doit être utilisée uniquement avec le système RASC[MD] Pronto[MD].

Niveau	Niveau attendu GB (K/µL)	Niveau attendu Neut %
Bas	2,1–3,9	30–50 %
Moyen	7,0–10,1	50–70 %
Élevé	20,2–24,4	70–90 %

ACCÈS AU PORTAIL DE SOINS AUX PATIENTS RASC[MD] 2

- Rendez-vous sur **www.csan.ca** pour accéder à la page de connexion
- Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur « Connexion »
- Pour obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe, communiquer avec le RASC[MD] au 1 800 267-2726

3 EXÉCUTER UNE ANALYSE AVEC UNE BANDELETTE DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE RASC[MD] PRONTO[MD]

A. Cliquer sur le logo RASC[MD] Pronto[MD] sur la page d'accueil

B. Cliquer sur « Analyse de contrôle »

C. Sélectionner « Bandelette de contrôle automatique »

D. Sélectionner l'appareil et cliquer sur « Suivant »

E. Entrez le numéro de lot de la bandelette de contrôle automatique RASC[MD] Pronto[MD] et cliquer sur « Suivant »

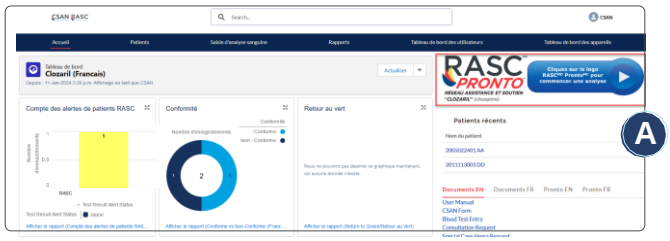

A

B

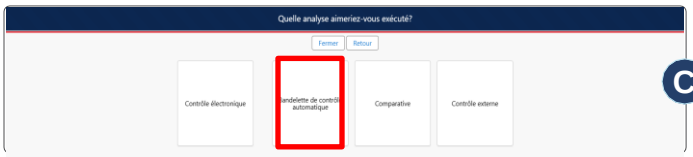

C

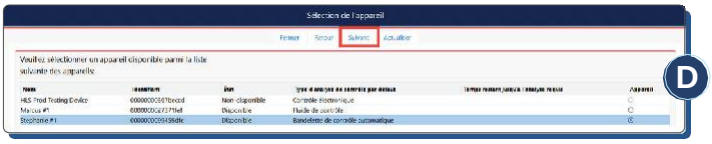

D

E

F G H

F Assurez-vous que la bande magnétique de la bande de contrôle automatique RASC[MD] Pronto[MD] soit insérée en premier dans l'appareil avec l'icône « Insérer » et la flèche vers le haut. Assurez-vous que la bandelette est exempte d'empreintes digitales et de contaminants en manipulant la bandelette par ses côtés.

G Une fois que la bandelette de contrôle automatique RASC[MD] Pronto[MD] est correctement insérée, le voyant devient bleu. Cliquez sur « Exécuter l'analyse ».

H Lorsque les trois niveaux ont été analysés, les résultats du test (« Succès » ou « Échec ») apparaîtront. Les trois niveaux doivent être réussis pour que le test soit réussi. Cliquez par la suite sur « Compléter ».

F

CONSULTATION DES RÉSULTATS – BANDELETTE DE CONTRÔLE RASC[MD] PRONTO[MD]

4

Les valeurs des résultats sont disponibles sur le tableau de bord du gestionnaire de périphériques. Chaque enregistrement de résultat comprend un niveau bas, normal et élevé. Chaque niveau comprend les valeurs retournées et la plage correspondante ainsi qu'une confirmation de réussite.

Détails Résultat Pronto

PR	PR-104137	Propriétaire	CSAN
ID de matériel de contrôle	47	Type d'enregistrement	Bandelette d'analyse pour QC externe
Numéro de lot de la bandelette	00014	Identifiant	Stephanie #1
Heure de début de l'analyse	29/06/2022 5:17 PM	Appareil	D-00151
Analyse terminé	29/06/2022 5:26 PM	Emplacement de l'appareil	DL-0072
Temps d'analyse utilisé (en minutes)	9	Message d'erreur	
Job Status		24 heures sans résultats	
Niveau 1 (Bas)			
Job ID	336941	Statue	Complété
Gamme G.B.	2.1 - 3.9	Gamme Neut %	30% - 50%
Valeur G.B.	3.10	Valeur Neut %	44.00%
G.B. réussi	Oui	Neut % réussi	Oui
Niveau 2 (Normal)			
Job ID	336942	Statue	Complété
Gamme G.B.	7 - 10.1	Gamme Neut %	51% - 70%
Valeur G.B.	8.40	Valeur Neut %	64.00%
G.B. réussi	Oui	Neut % réussi	Oui
Niveau 3 (Haut)			
Job ID	336943	Statue	Complété
Gamme G.B.	20.2 - 24.4	Gamme Neut %	71% - 90%
Valeur G.B.	21.40	Valeur Neut %	78.00%
G.B. réussi	Oui	Neut % réussi	Oui
Créé par	CSAN, 29/06/2022 5:17 PM	Dernière modification par	CSAN, 29/06/2022 5:26 PM

ENTREPOSAGE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BANDELETTES DE CONTRÔLE RASC[MD] PRONTO[MD]

5

Entreposage et entretien : Pour maintenir le bon fonctionnement de la bandelette de contrôle RASC[MD] Pronto[MD], les conditions de stockage ne doivent pas varier en dehors d'une plage de température de 15 à 30 °C ni dépasser 60 % d'humidité. Le dispositif doit être conservé dans l'emballage fourni avec la bandelette de contrôle RASC[MD] Pronto[MD].

Nettoyage : Pour éliminer les empreintes digitales et les contaminants, la vitre de protection peut être nettoyée avec un chiffon de nettoyage doux en microfibre.

La fréquence recommandée pour le test de la bandelette de contrôle RASC[MD] Pronto[MD] : au moins une fois par mois. Une fréquence définie peut être établie par le gestionnaire de l'appareil, et l'utilisateur final sera invité à effectuer le test de la bandelette de contrôle RASC[MD] Pronto[MD] à ce moment-là. Si le test n'est pas effectué, l'appareil se bloque automatiquement.

HLS Therapeutics Inc.
10 Carlson Court, bureau 701
Etobicoke (Ontario) M9W 6L2
www.hlstherapeutics.com

CLOZARIL et RASC sont des marques déposées de Novartis AG.
Pronto est une marque déposée de HLS Therapeutics Inc. Tous droits réservés.
© 2024 HLS Therapeutics Inc.

Code produit : 2022HLS006FR
Janvier 2025 -CA-CP-00053-FR Numéro de contrôle de l'illustration HLS : 2022HLS006